Gentofte Hospital	sagsnr. 10.4098.01	ES. 7
Skærmet Installation	1/11/2008	Init.: GGG

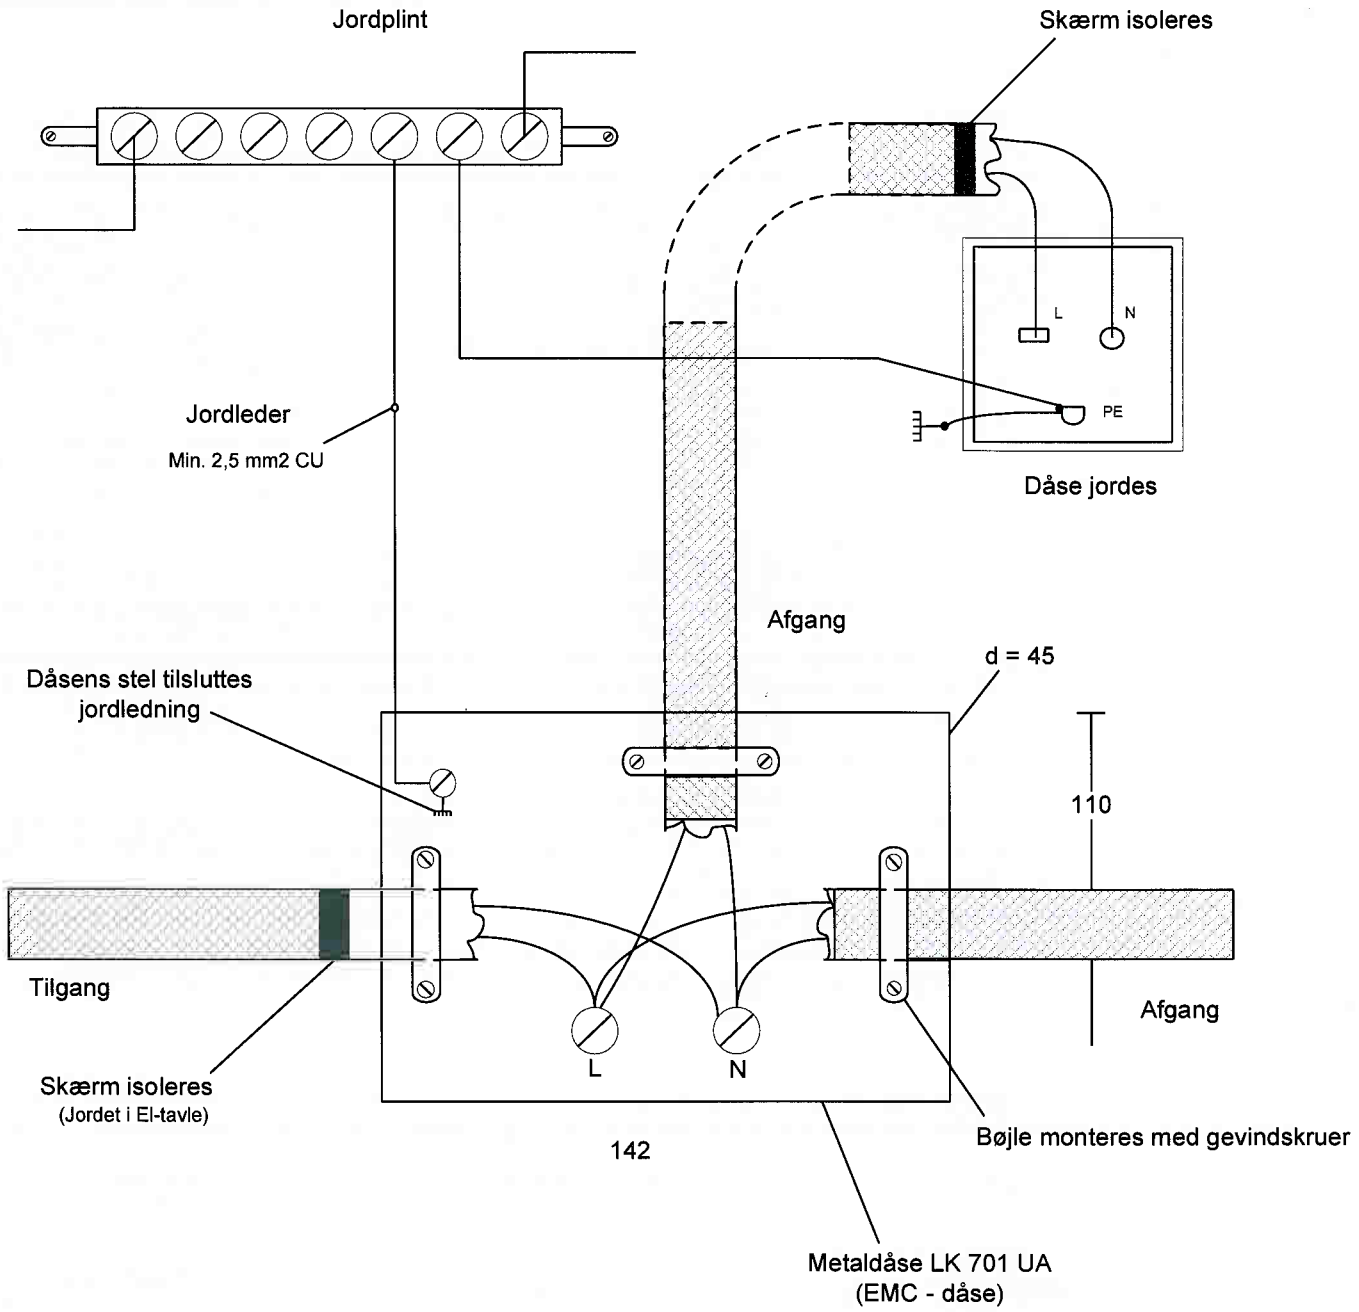

Kabler 2 * 1,5 mm2 (uden PE-leder)